


Kit de amplicones personalizados TruSeq Dx[®]

Formulario de seguimiento del kit y flujo de trabajo

PARA USO DIAGNÓSTICO *IN VITRO*

Para obtener instrucciones detalladas, consulte el *prospecto del kit de amplicones personalizados TruSeq Dx* (n.º de documento 1000000029772).

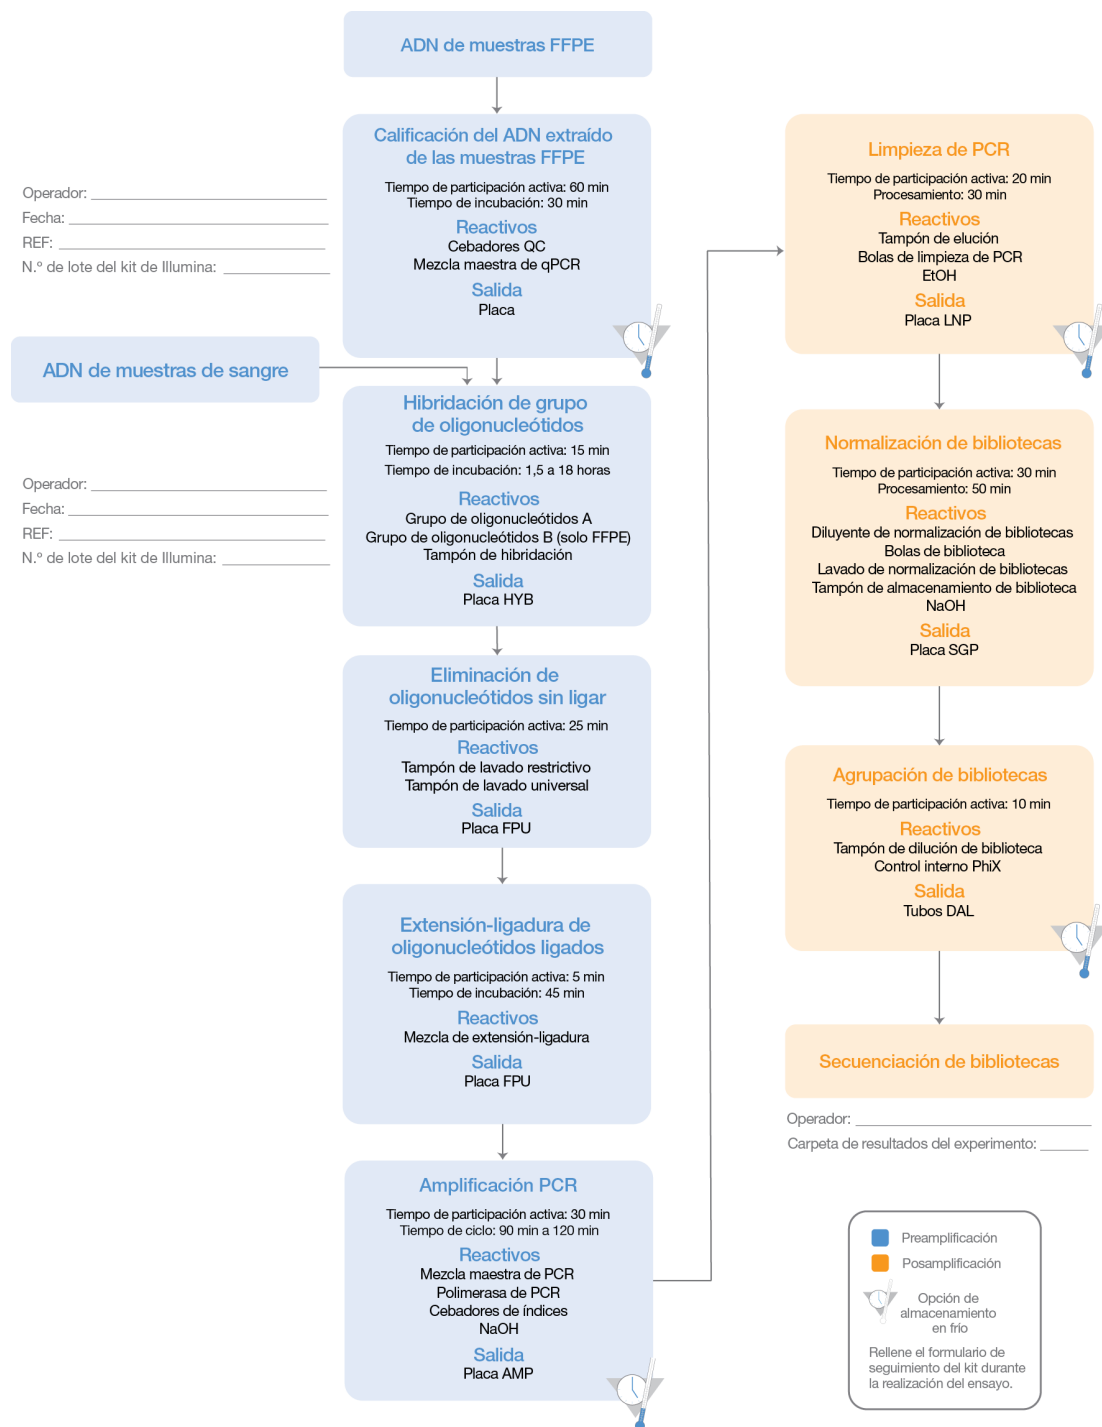


Kit de amplicones personalizados TruSeq Dx

Formulario de seguimiento del kit y flujo de trabajo

[Página en blanco intencionada]



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, California 92122 (EE. UU.)
+1 800 809 ILMN (4566)
+1 858 202 4566 (fuera de Norteamérica)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Netherlands B.V.
Steenoven 19
5626 DK Eindhoven
Países Bajos



Patrocinador australiano:
Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association Building
Level 3, 535 Elizabeth Street
Melbourne, VIC 3000
Australia